



Apeiron Synthesis S.A.  
ul. Duńska 9  
54-427 Wrocław



Tel. 71 7985 621 | Fax 71 7985 622

Wrocław, dnia 08.06.2020

### WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe nr ZO/20200603

Głoszenie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 03.06.2020 r. pod nr 32052


Upieramie informuję, iż w dniu 04.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy.

**Pytanie:** Czy Badanie udarności policyklopentadienu zgodnie z normą PN-EN ISO 180:2004) może być przeprowadzone metodą Charpy'ego?

**Odpowiedź:** Nie. Wykonawca wymaga, aby badanie udarności było przeprowadzone metodą Izoda.

**Pytanie:** W jakiej formie (kształt oraz wymiary) Zamawiający dostarczy próbki do badania wytrzymałości policyklopentadienu na rozciąganie (zgodnie z normą ASTM D638)?

**Odpowiedź:** Próbki do badania wytrzymałości policyklopentadienu na rozciąganie (zgodnie z normą ASTM D638), które będą dostarczane przez Zamawiającego mają kształt wiosełek o wymiarach opisanych w normie ASTM D638 (typ I) z wyjątkiem grubości, która wynosi 13 mm.

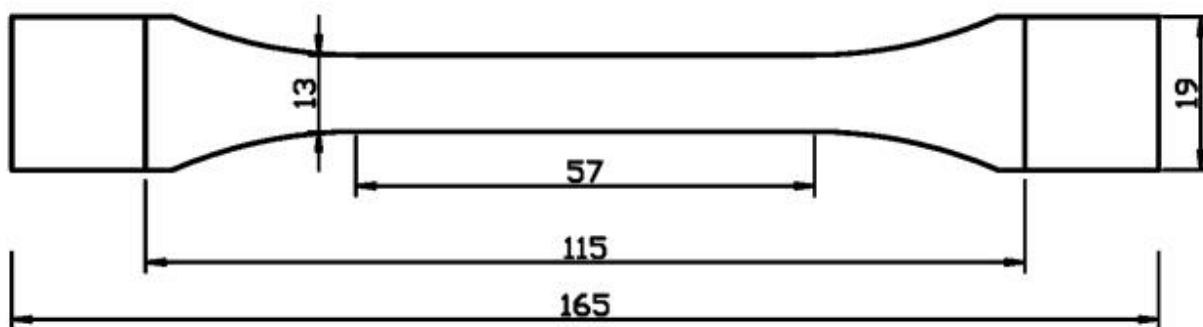

Z poważaniem  
Małgorzata Dubikowska